



Produkttestauswertung

Hebammen-testen.de

Anti-colic Flasche



Test- & Hebammeninformation

1. Bewerbungsphase: 24. Jan. – 27. Feb. 2019

Anzahl der Bewerberinnen: 120

2. Testphase: 13. Mrz. – 15. Mai 2019

Anzahl der Testerinnen: 100

3. Auswertung

Anzahl der Bewertungen: 100

100 % Rückmeldungsquote

Berufserfahrung

1-5 Jahre 34 %

6-10 Jahre 30 %

11-15 Jahre 11 %

16+ Jahre 18 %

k. A. 7 %

74 % haben eigene Kinder

*Insgesamt 86 Nennungen

42 % haben eine Zusatzausbildung u. a. als Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, Arzthelferin, Familienhebamme oder Bachelor/Master Hebammenwesen, Still- und Laktationsberaterin, Heilpraktikerin, Massagetherapeutin



Auswahl Bewerberzitate

Ich möchte testen, weil...

„...Koliken ein ständiger Begleiter vieler jungen Familien in den ersten Lebenswochen sind und viele verzweifelt auf der Suche nach Besserung sind! Ich würde also gerne mit einer betroffenen Familie testen.“

28 Jahre, 6 Jahre im Beruf, 2 Kinder, freiberuflich, Familienhebamme

„...es Kinder gibt, die mit bestimmten Flaschen nicht zurecht kommen, oder denen das Trinken aus der Flasche mehr Blähungen macht. Um jede Flasche, die das verhindert bin ich froh.“

33 Jahre, 5,5 Jahre im Beruf, 2 Kinder, freiberuflich im Krankenhaus

„...ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Sauger die der Brustwarze am ähnlichsten sind, besonders gut angenommen werden bei Stillkindern.“

33 Jahre, 9 Jahre im Beruf, 2 Kinder, freiberuflich, Bachelor Hebammenwesen

91 % der Hebammen empfehlen die
Anti-colic Flasche weiter.



Hebammen-
testen.de



**91 %
Empfehlung**

für Philips Avent
Anti-colic Flasche

von 100 Hebammen
05/2019

www.hebammen-testen.de

Die Anti-colic Flasche überzeugt.

Positive Rückmeldung

- **97 %** bewerten die Verarbeitung der Philips Avent Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.
- **94 %** bewerten die Hochwertigkeit der Materialien mit gut bis sehr gut.
- **92 %** bewerten die Qualität der Philips Avent Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.
- **90 %** bewerten die Füllmenge der Philips Avent Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.
- **90 %** bewerten den Sauger mit gut bis sehr gut.
- **89 %** bewerten die Handhabung der Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.

Wenige Kritikpunkte

- „Milch bleibt in der waagerechten Haltung nicht im Sauger. Der Sauger war dem Baby zu klein, viel Milch ist seitlich ausgelaufen.“
- „Sollte nicht nur in einer bestimmten Position funktionieren sondern egal wie man die Flasche hält.“
- „Das Design könnte etwas freudiger, bunter sein.“

Auf einen Blick

Kategorie	Note*	Bewertung
Verarbeitung	1,3	sehr gut
Qualität	1,5	sehr gut
Sauger	1,6	gut
Handhabung	1,6	gut
Füllmenge	1,7	gut
Design	1,7	gut


*alle folgenden Noten und Bewertungen basieren auf dem Bewertungsschlüssel (s. Anhang)

Das sagen Hebammen

- „Gutes Produkt, weniger Koliken/Blähungen/Luft schlucken.“
- „Sehr gut! Leicht in der Handhabung.“
- „Eine gute Anti-colic Flasche, nettes Design.“
- „Ein interessanter und innovativer Mechanismus.“
- „Hochwertige Flasche. Eine gute Flasche im typischen, hochwertigen Avent Design gut zu handhaben.“
- „Empfehlenswertes Flaschensystem.“

Ergebnisse

Nutzen Sie bereits andere Produkte der Marke Philips Avent?

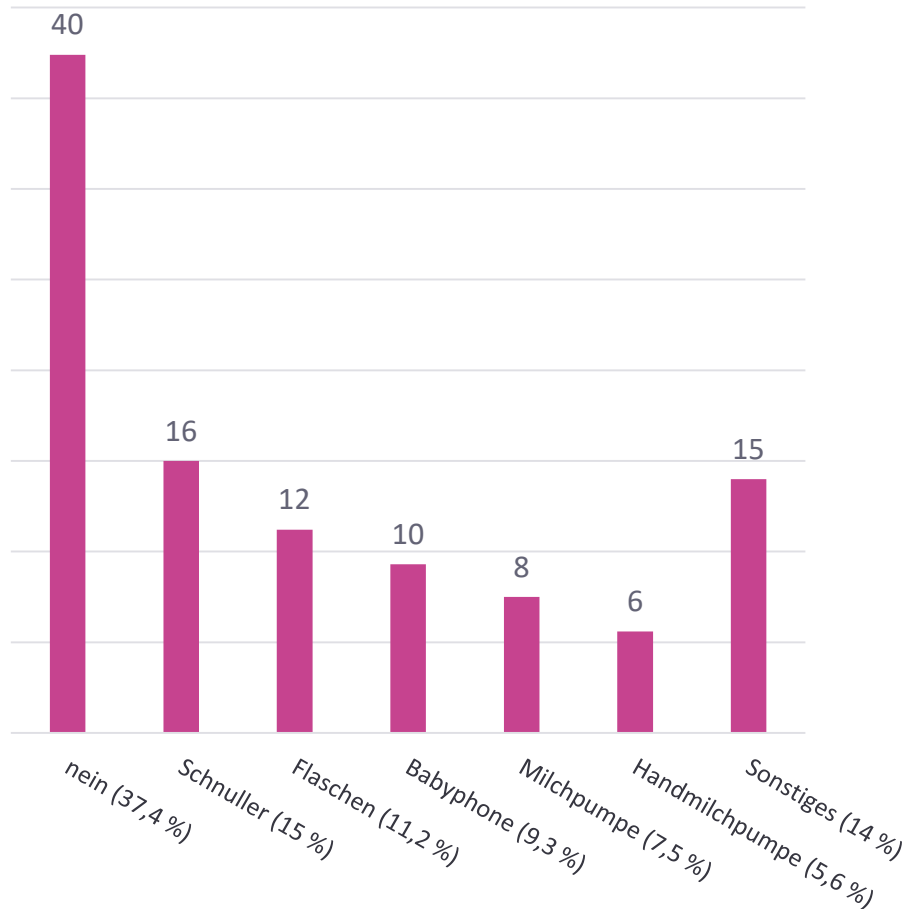


*Mehrfachnennung möglich

*Insgesamt 107 Nennungen


Folgende „andere Produkte“ der Marke Philips Avent wurden genannt:

- Naturnah-Flaschen
- Aufbewahrungssystem für Babynahrung
- Sterilisator
- Stilleinlagen
- Stillhütchen
- Flaschenwärmer
- Natural Wave Sauger
- Vaporisator
- Ohrthermometer Milchpumpe
- Sauger
- Beruhigungssauger
- Babykost Zubereiter

Womit verbinden Sie die Marke Philips Avent?

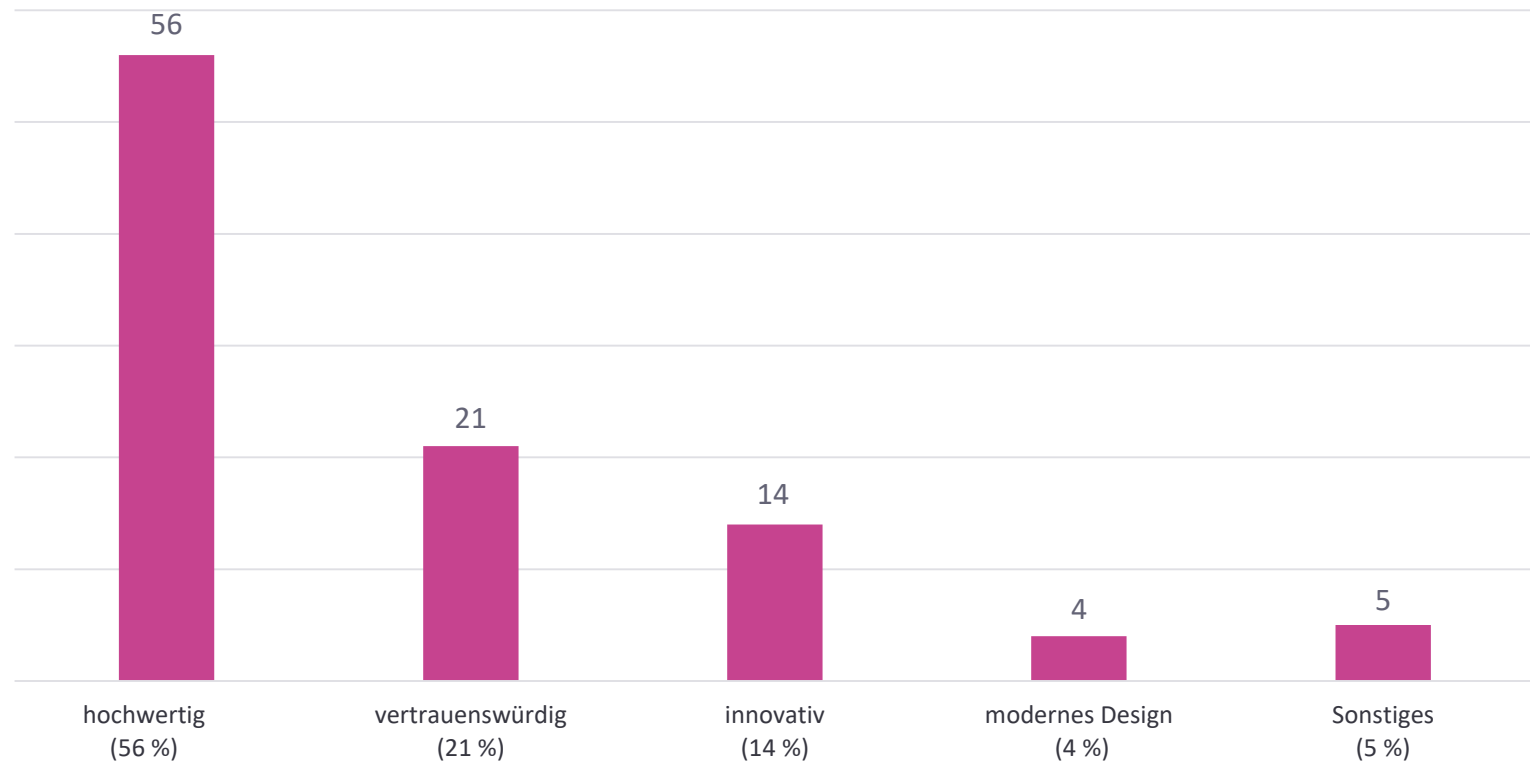


Welche Anti-colic Flasche (Marke & Modell) haben Sie bisher bevorzugt verwendet oder empfohlen?

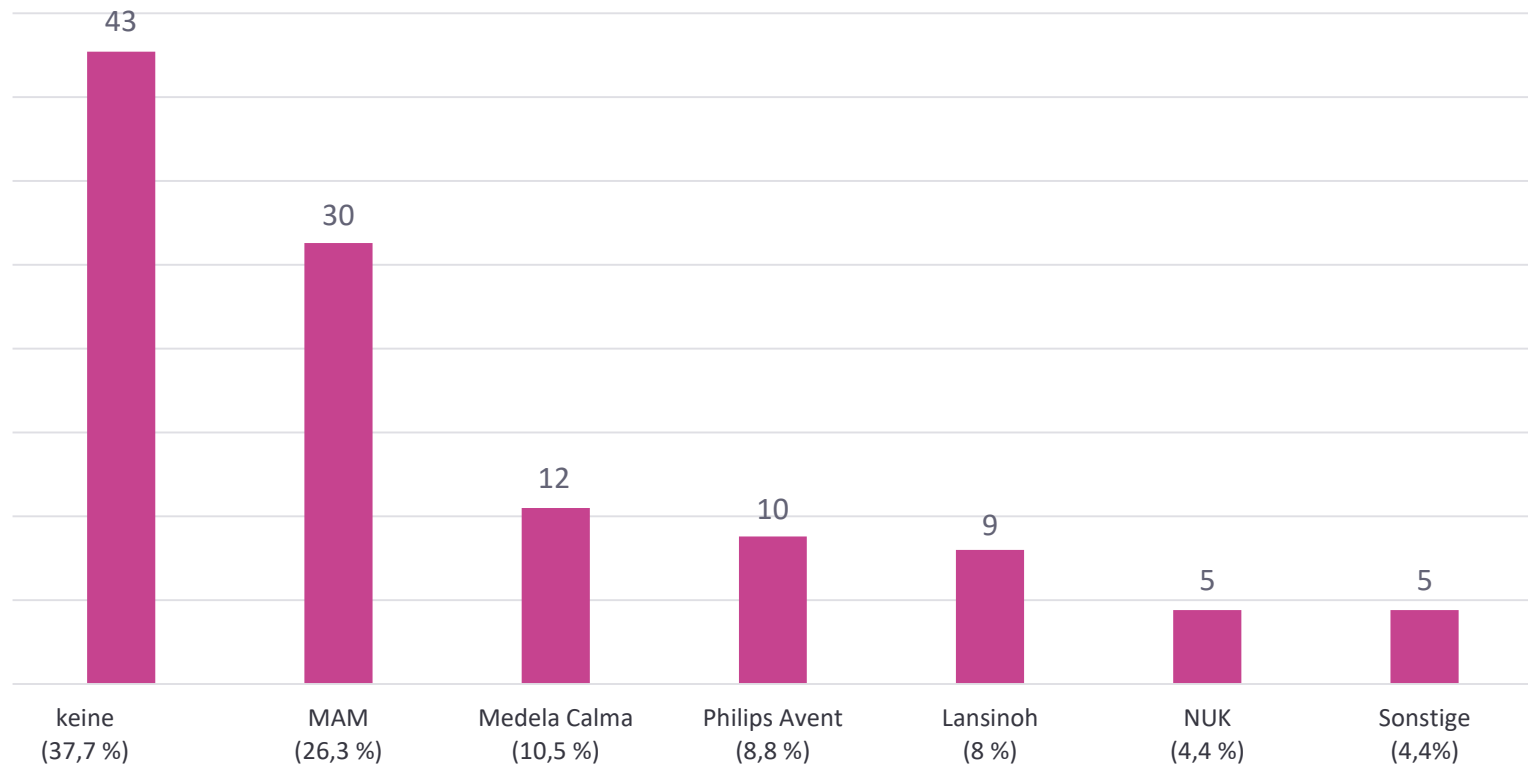

*Mehrfachnennung möglich


*Insgesamt 114 Nennungen

Wie alt war das Baby mit dem Sie getestet haben?

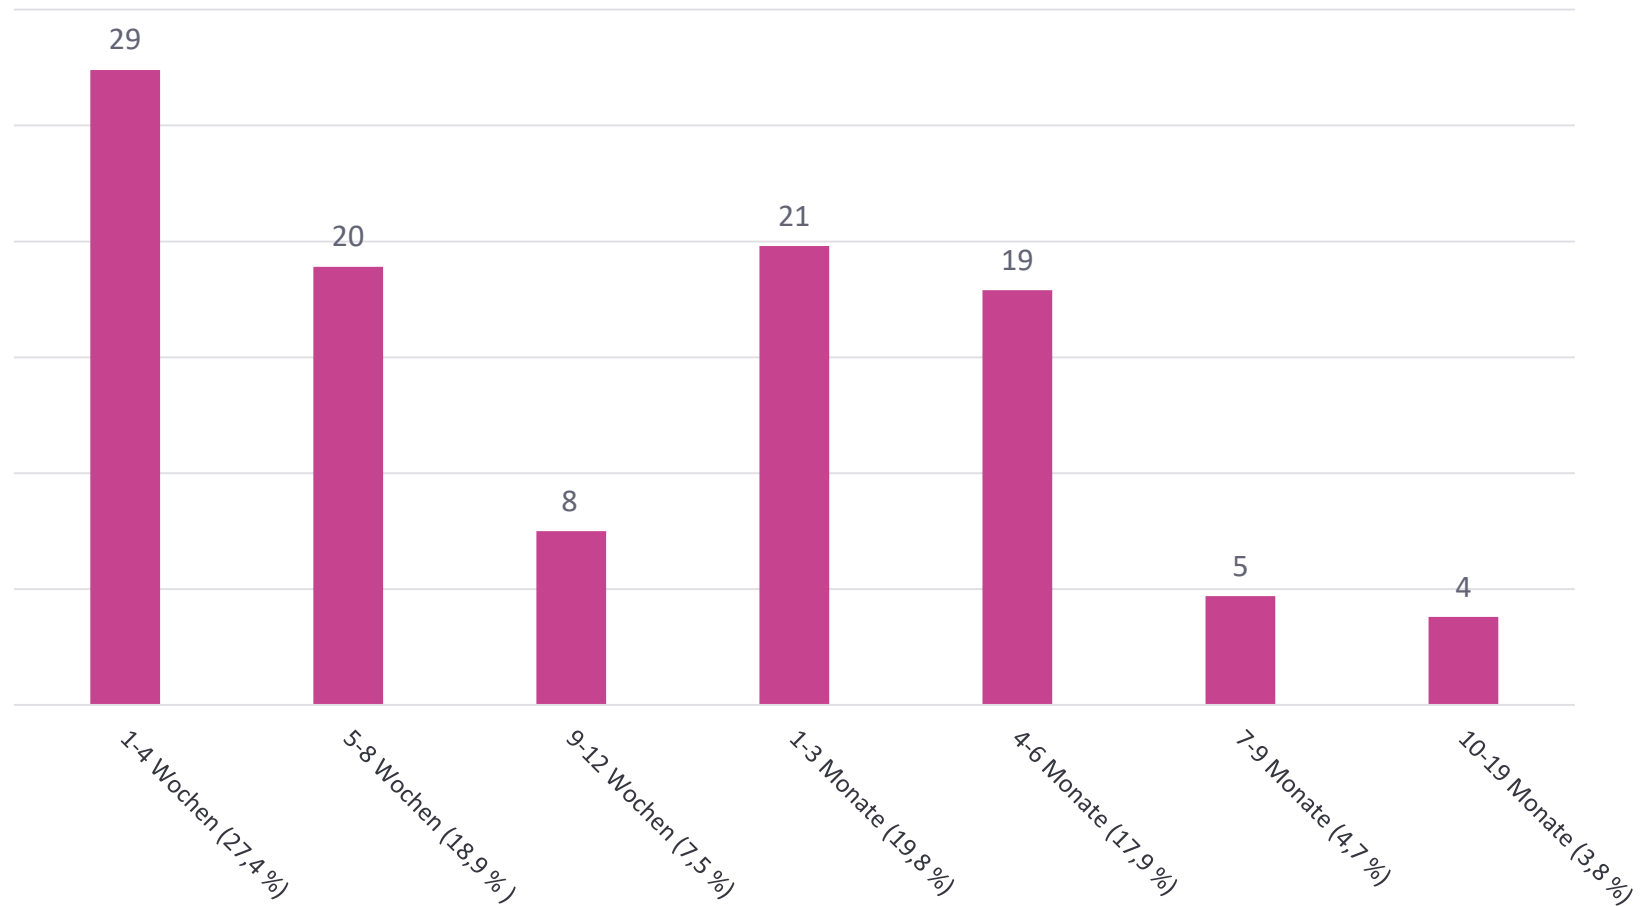


*Mehrfachnennung möglich
*Insgesamt 106 Nennungen


War Ihnen zuvor bewusst, dass Philips Avent eine Anti-colic Flasche anbietet?

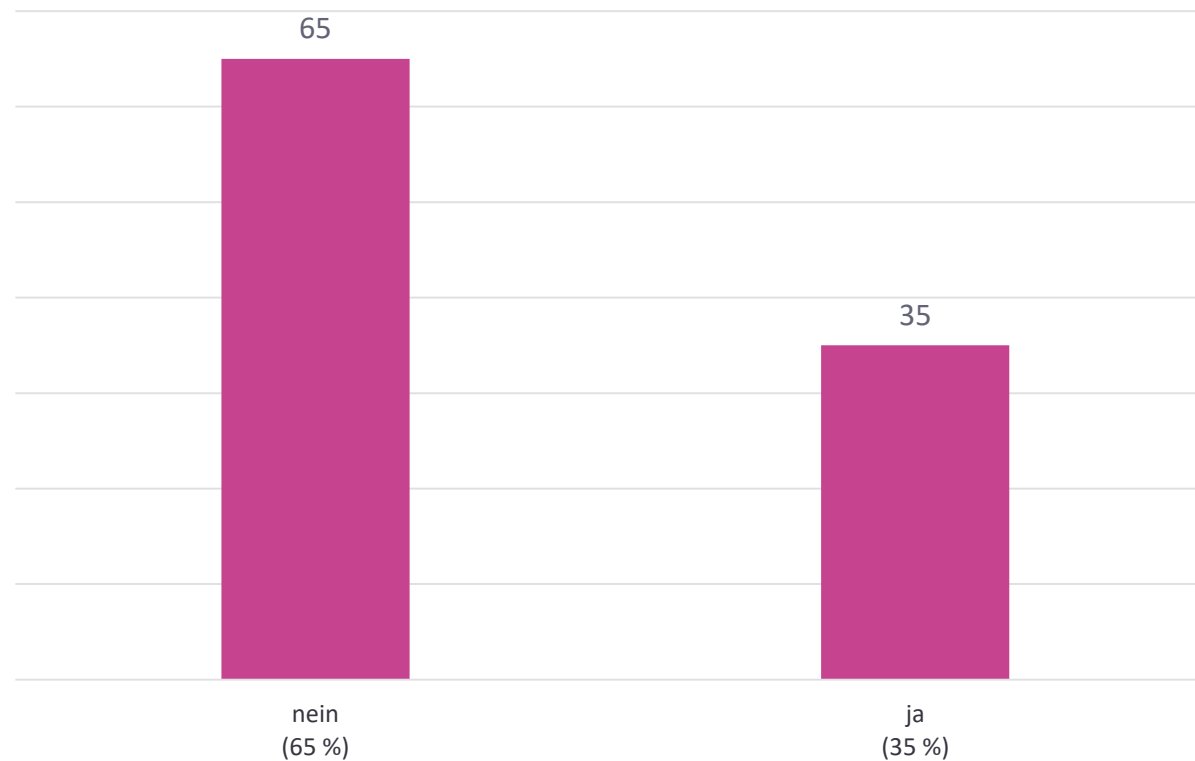


Mit welchem Baby haben Sie die
Anti-colic Flasche getestet?

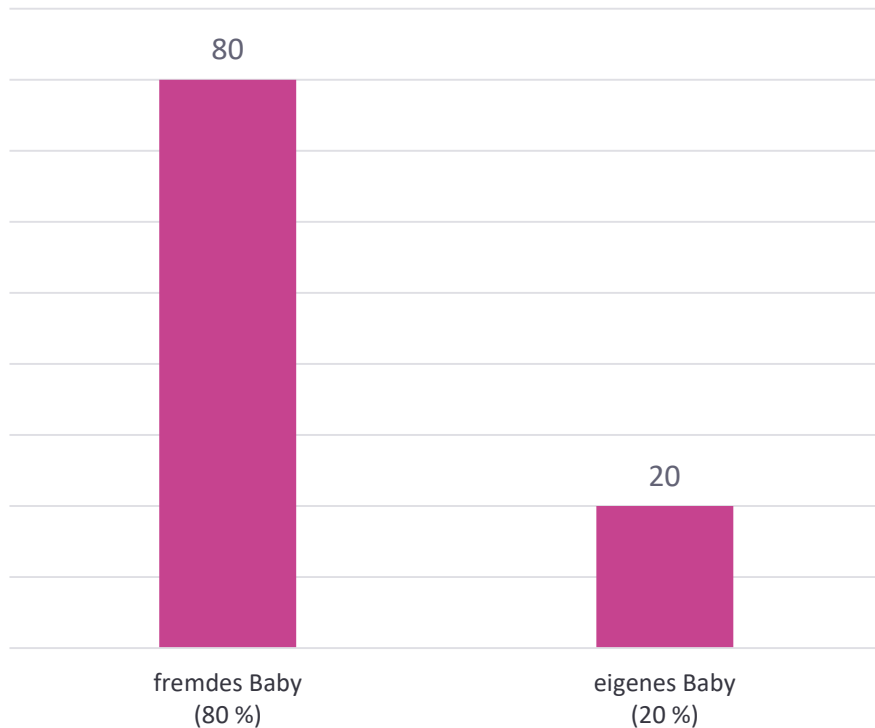

Wurde das Baby, mit dem Sie die
Anti-colic Flasche getestet haben,
zeitlich gestillt?

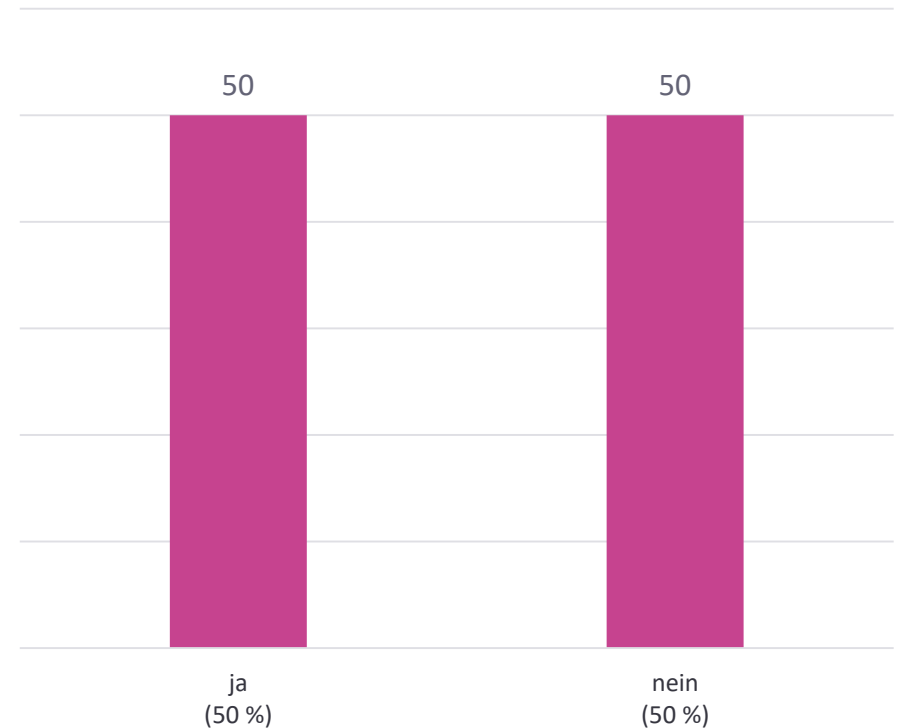


Wo haben Sie die Philips Avent Anti-colic Flasche hauptsächlich genutzt?

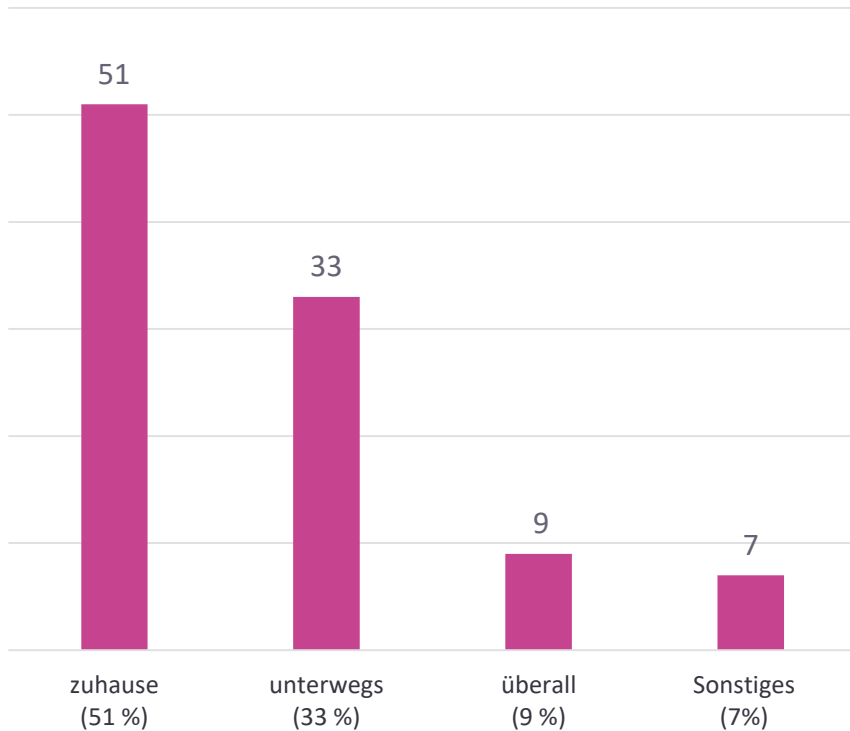

Wie bewerten Sie die Qualität der Philips Avent Anti-colic Flasche?


Note: 1,5

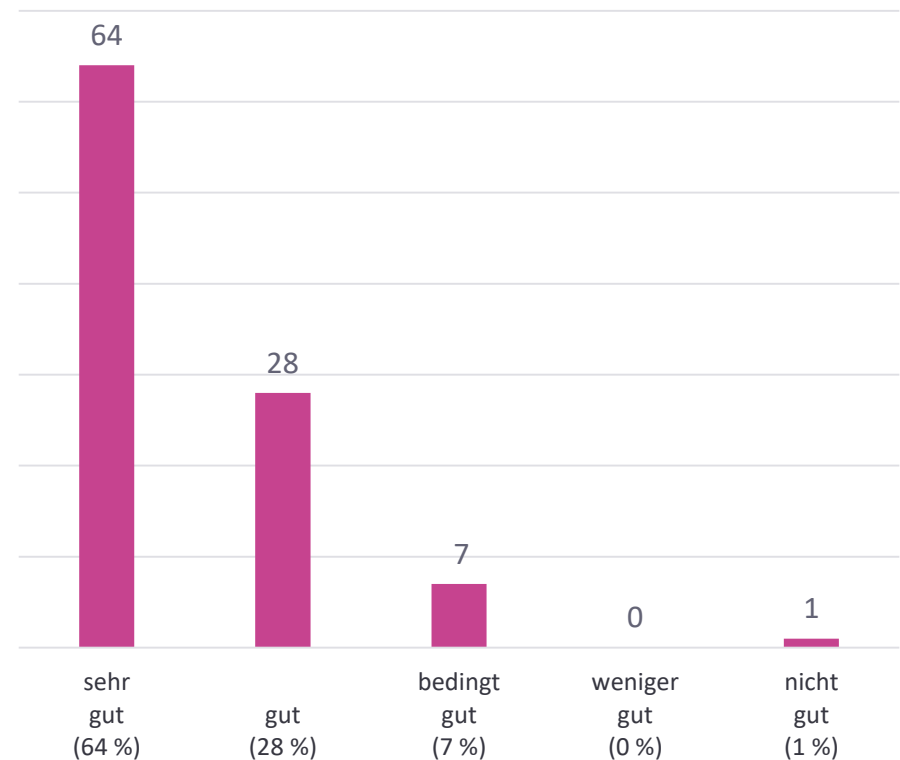

92 % bewerten die Qualität der Philips Avent Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.

Wie bewerten Sie die Verarbeitung der Philips Avent Anti-colic Flasche?


Note: 1,3

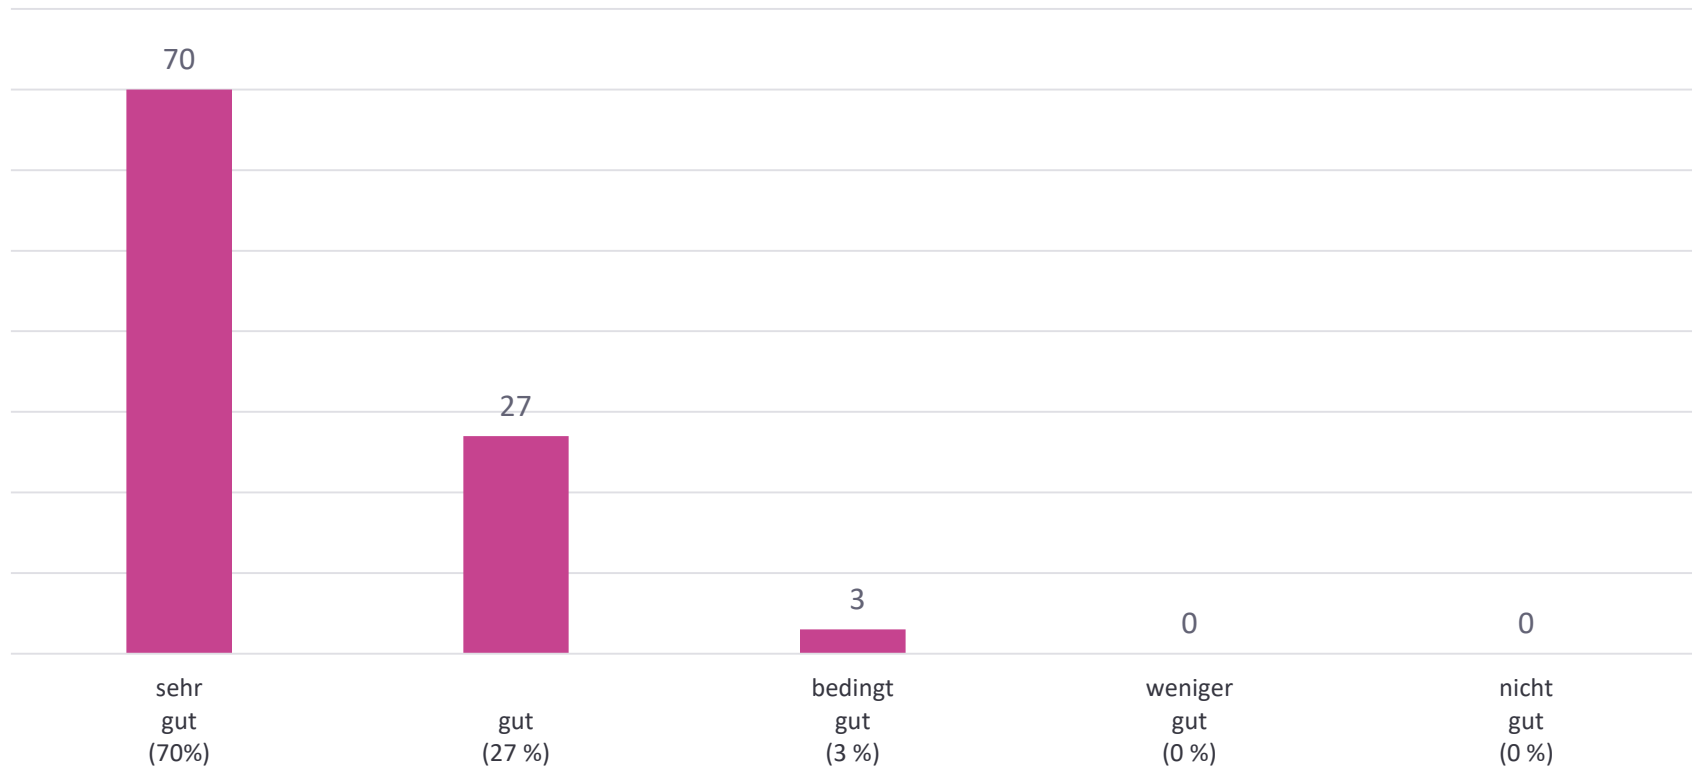

97 % bewerten die Verarbeitung der Philips Avent Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.

Wie bewerten Sie die Hochwertigkeit der Materialien der Philips Avent Anti-colic Flasche?


Note: 1,4

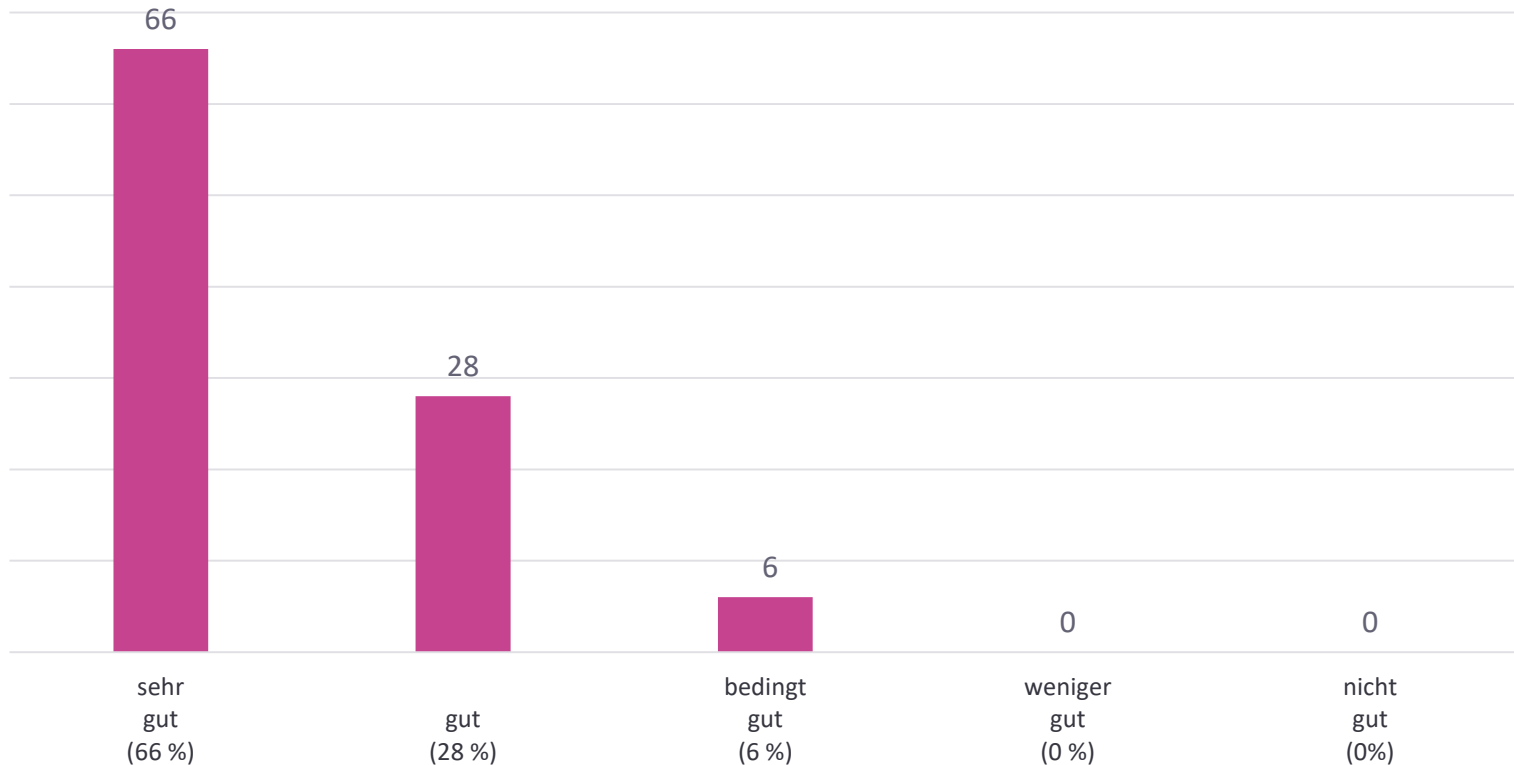

94 % bewerten die Hochwertigkeit der Materialien mit gut bis sehr gut.

Wie bewerten Sie das AirFree (TM) Ventil?


Note: 1,7

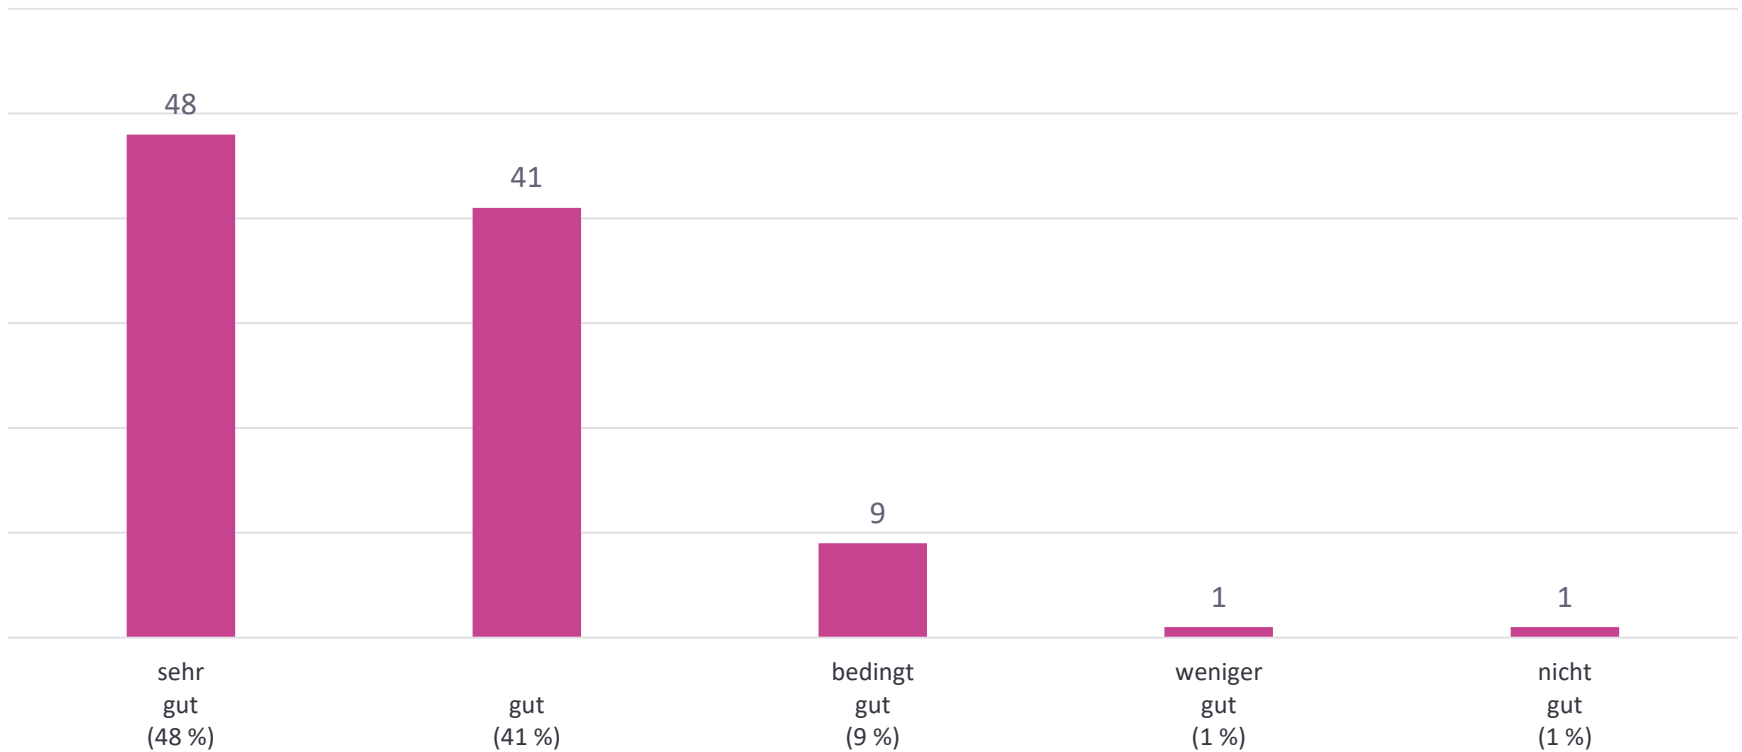

89 % bewerten das AirFree (TM) Ventil mit gut bis sehr gut.


Wie bewerten Sie die Füllmenge der Philips Avent Anti-colic Flasche?

Note: 1,7

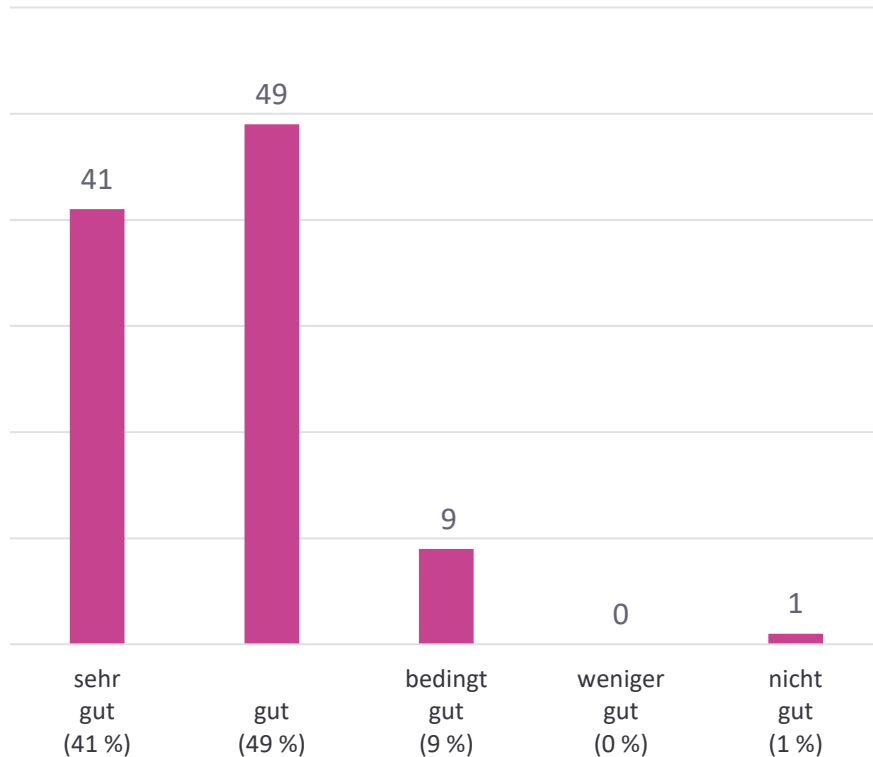


90 % bewerten die Füllmenge der Philips Avent Anti-colic Flasche als gut bis sehr gut.

Für wie wichtig empfinden Sie eine aufrechte Fütterposition?

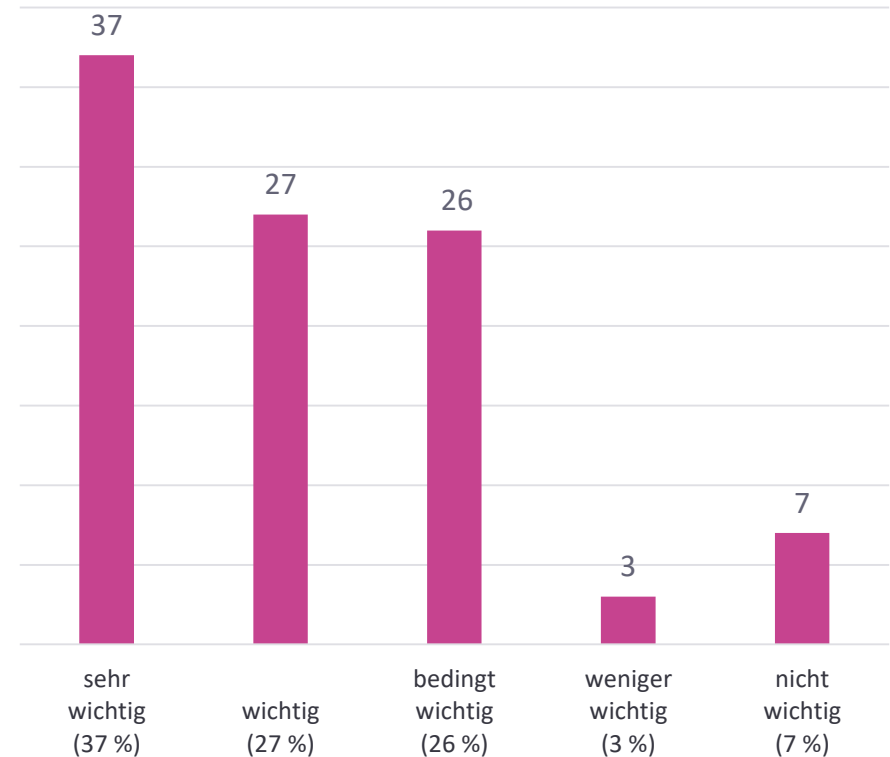

64 % empfinden eine aufrechte Fütterposition als wichtig bis sehr wichtig.

Konnte die Philips Avent Anti-colic Flasche eine aufrechte Fütterposition ermöglichen?

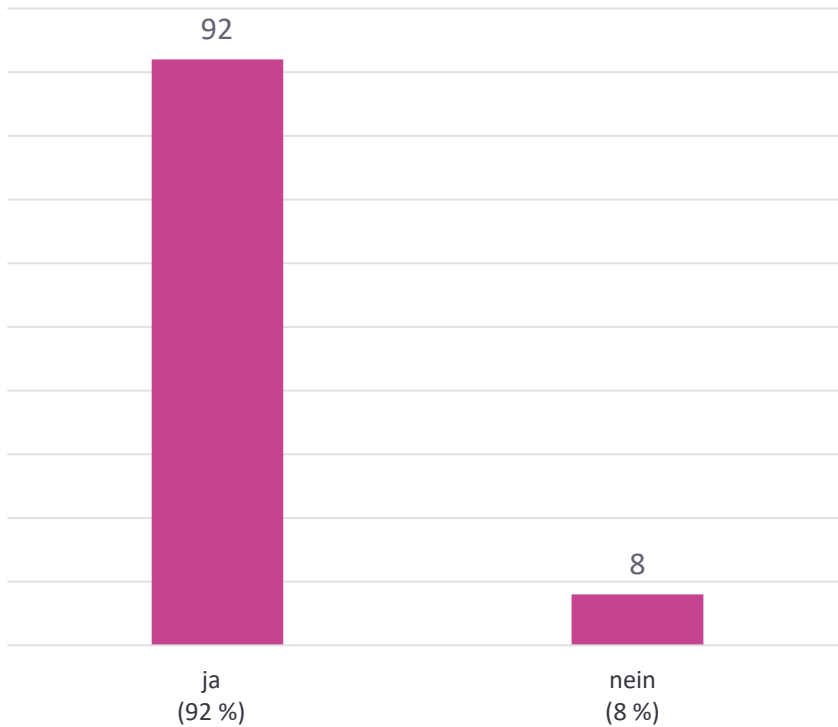


Wie bewerten Sie den Sauger?

Note: 1,6




90 % bewerten den Sauger mit gut bis sehr gut.


Beurteilen Sie folgende Aussage:
Durch die Verwendung der Philips
Avent Anti-colic Flasche hat das
Baby weniger Luft geschluckt.

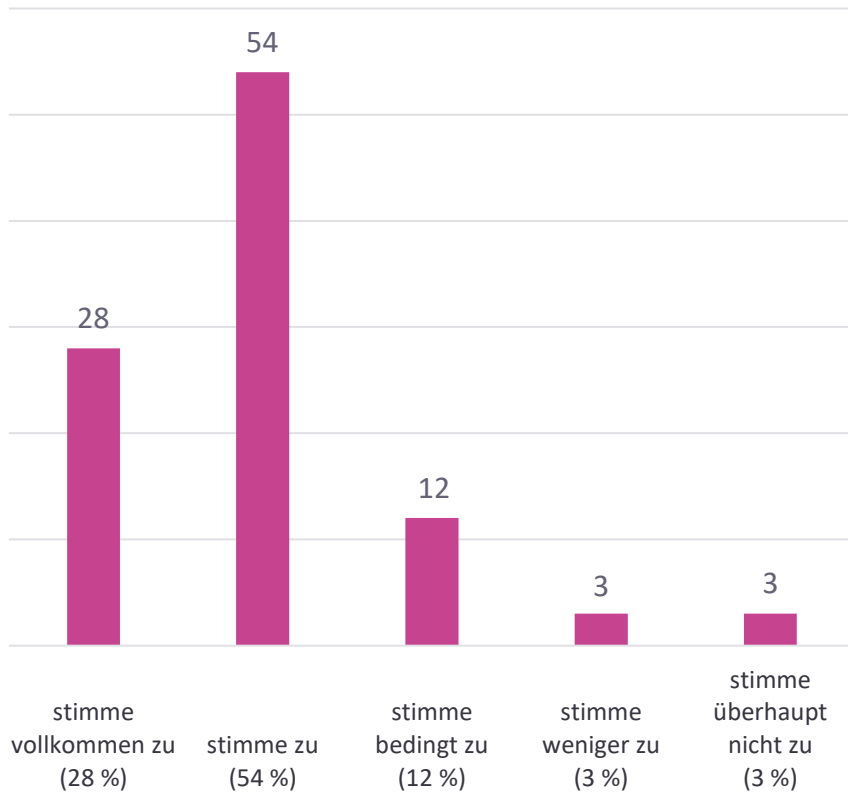


Beurteilen Sie folgende Aussage:
Durch die Verwendung der Philips
Avent Anti-colic Flasche wurde das
Auftreten von Koliken reduziert.

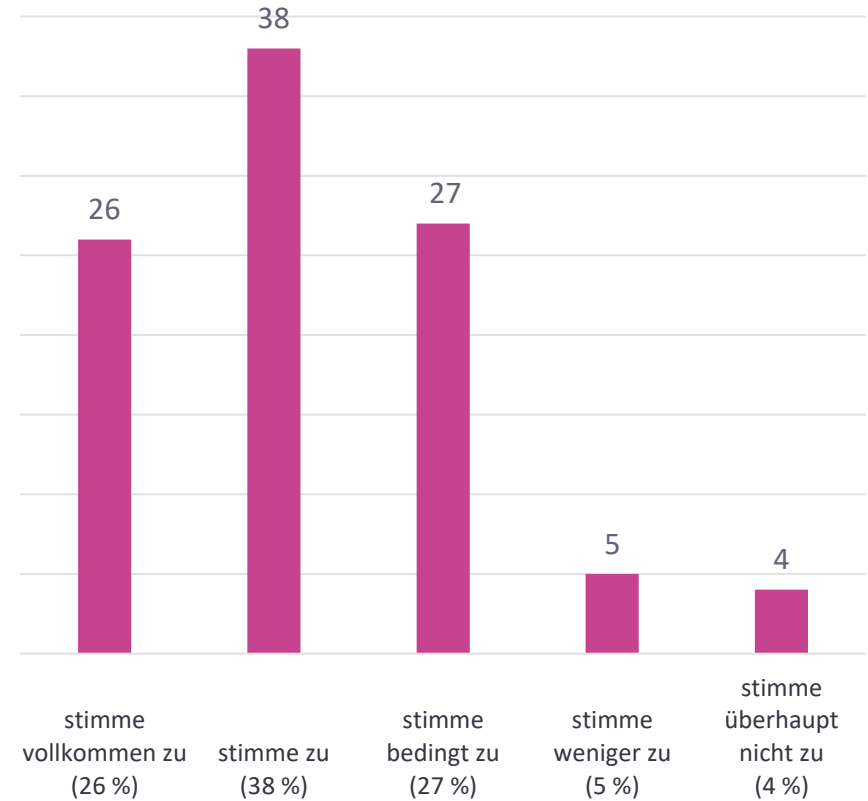


Beurteilen Sie folgende Aussage:
Durch die Verwendung der Philips
Avent Anti-colic Flasche wurde das
Auftreten von Blähungen reduziert.

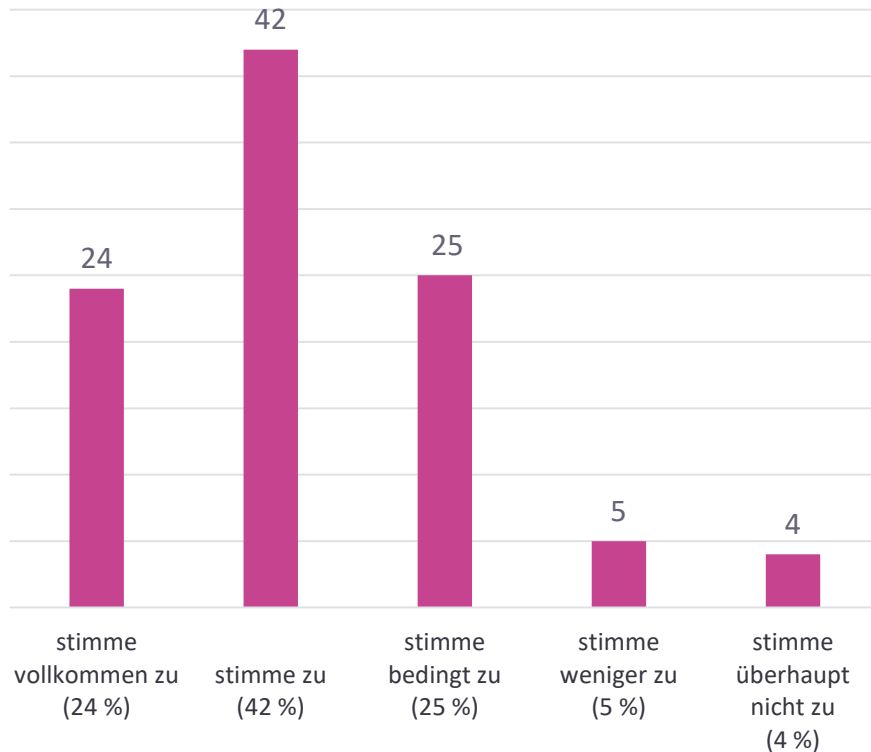

Beurteile Sie folgende Aussage: Durch
die Verwendung der Philips Avent
Anti-colic Flasche wurde das Auftreten
von Reflux reduziert.

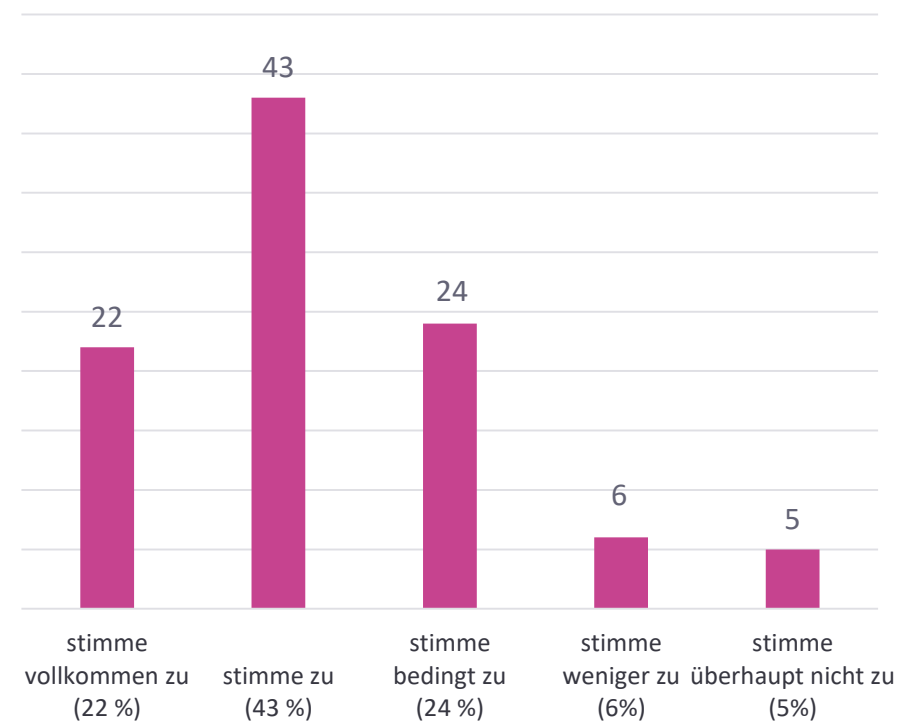


Bestätigen Sie, dass durch die Verwendung der Philips Avent Anti-colic Flasche das Unwohlseins des Babys aufgrund von Koliken/Blähungen/Reflux reduziert wurde?

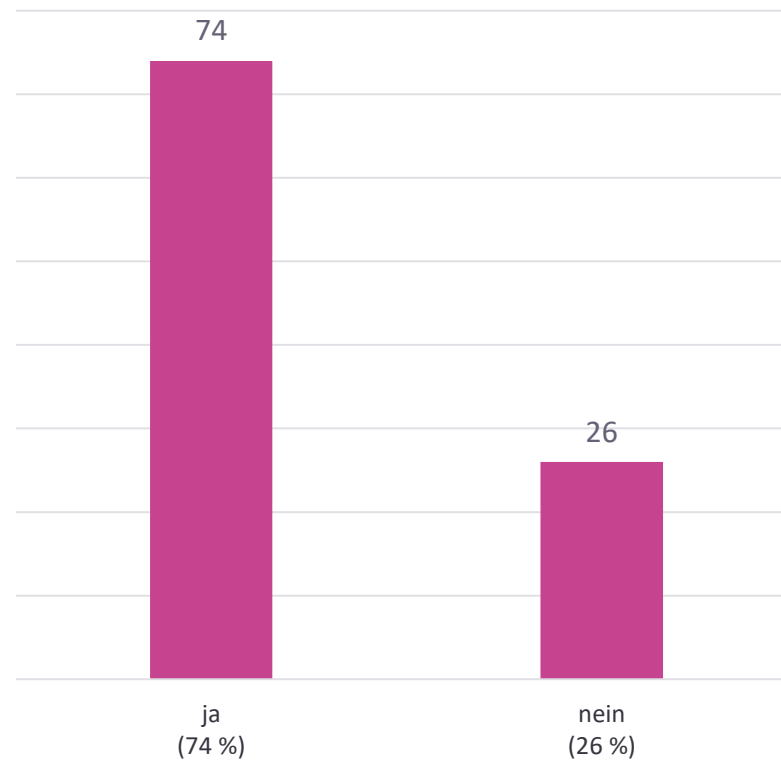

Wie bewerten Sie das Design der Anti-colic Flasche?

Note: 1,7

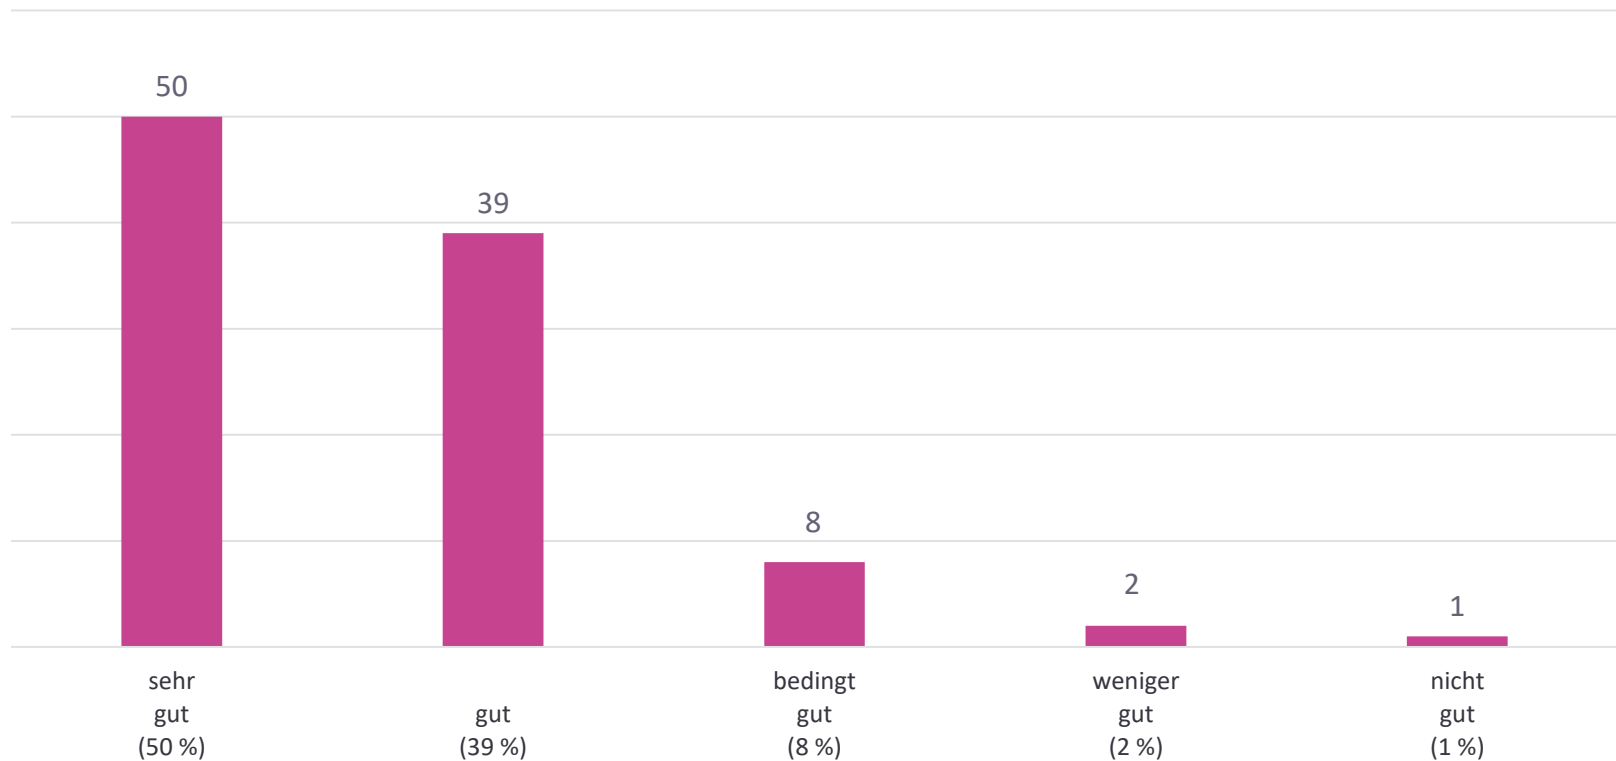

89 % bewerten das Design der Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.

Wie bewerten Sie die Handhabung der Anti-colic Flasche?


Note: 1,6



89 % bewerten die Handhabung der Anti-colic Flasche mit gut bis sehr gut.

Wie bewerten Sie die Reinigung der Philips Avent Anti-colic Flasche?

Note: 1,8


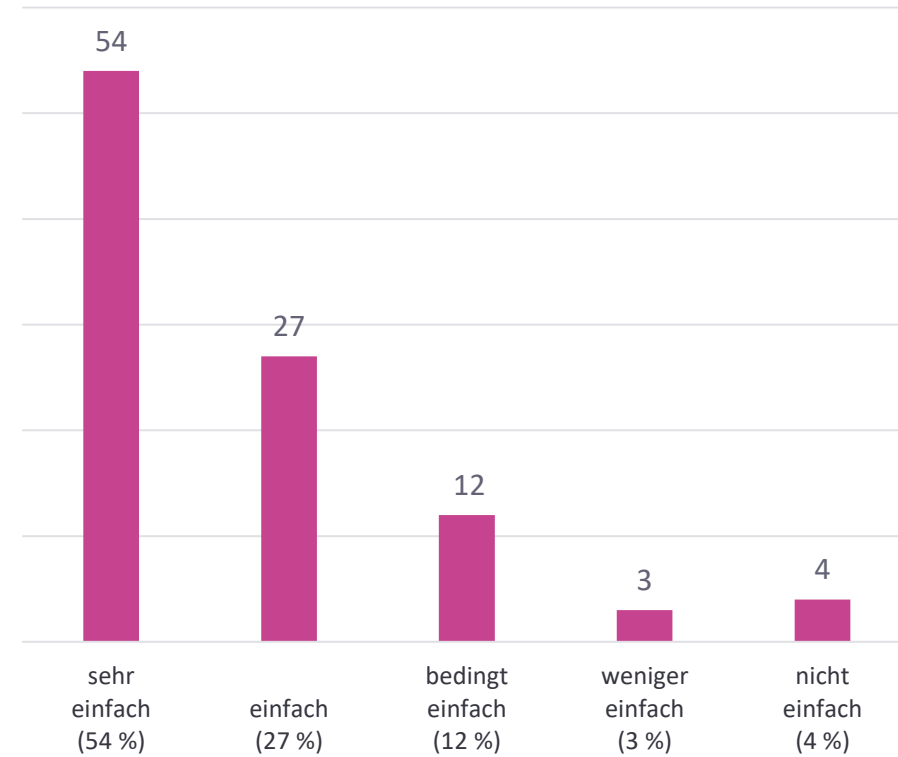


81 % bewerten die Reinigung der Philips Avent Anti-colic Flasche mit einfach bis sehr einfach.

Erfüllt die Philips Avent Anti-colic Flasche Ihre Hygieneansprüche?


Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis der Anti-colic Flasche?

Note: 2

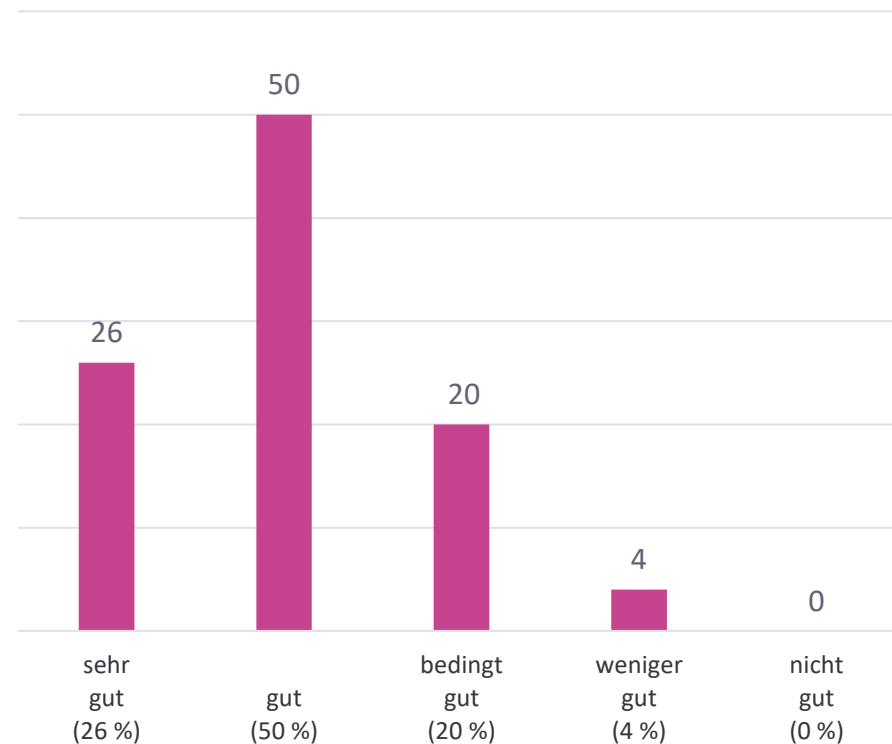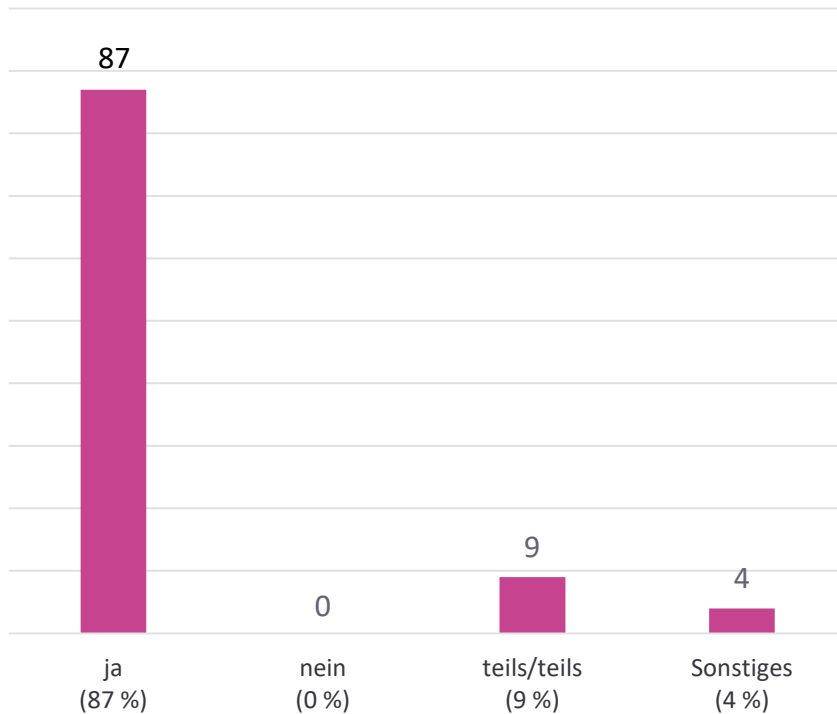

76 % bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis der Anti-colic Flasche als gut bis sehr gut.

Würden Sie etwas an der Philips Avent Anti-colic Flasche verbessern?

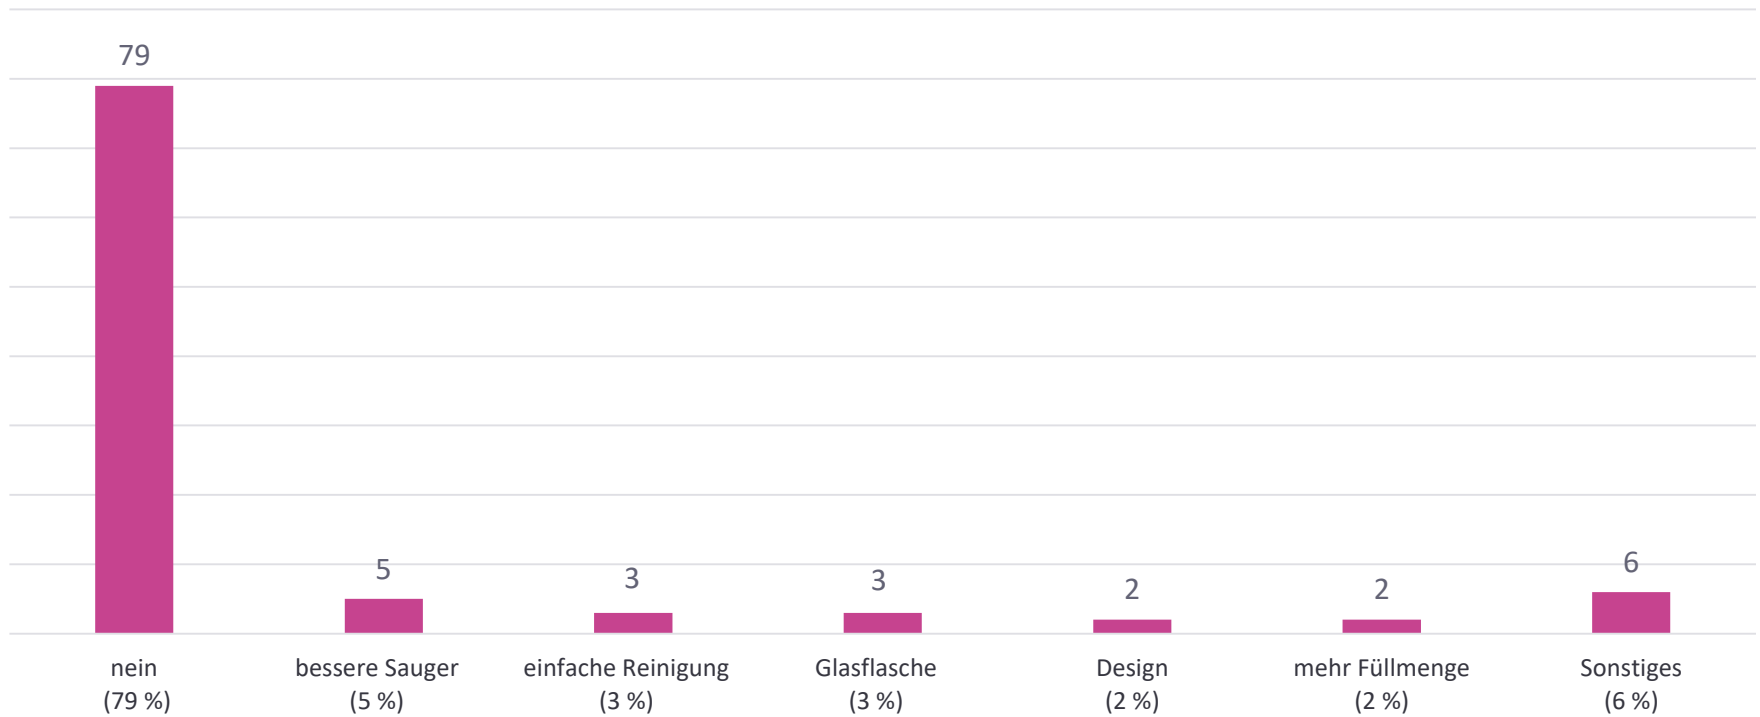



„Gewohnt gute Qualität von Philips Avent, Flasche sehr gut in der Anwendung. Das Baby hat die Flasche gut akzeptiert und gut daraus getrunken, kein Verschlucken oder Spucken.“

39 Jahre, 16 Jahre im Beruf, 2 Kinder, freiberuflich im Krankenhaus

„Ich bin absolut begeistert von dieser Flasche! Mein Baby schluckt auch in aufrechter Position beim Trinken überhaupt keine Luft. Das AirFree-Ventil ist eine echte Innovation für mich! Empfehle diese Flasche auf jeden Fall 100% weiter!“

31 Jahre, 6 Jahre im Beruf, 1 Kind, freiberuflich, Arzthelferin

„Ich bin wirklich zu 100 Prozent überzeugt, meine Tochter spuckt nicht mehr und hat kaum noch Beschwerden. Würde es definitiv bei meinem zweiten Kind auch benutzen und weiterempfehlen.“

29 Jahre, 4 Jahre im Beruf, 1 Kind, im Krankenhaus



„Der Sauger war für das Baby angenehm. Die Flasche ist sehr gut zu reinigen. Das Füttern mit der Flasche und das Stillen im Wechsel haben super geklappt.“

40 Jahre, 7 Jahre im Beruf, freiberuflich

„Sehr gute Qualität und das Aufnehmen von Luft beim Trinken wird deutlich reduziert. Die Flasche lässt sich recht einfach reinigen, nur durch das AirFree-Ventil ist es ein wenig schwieriger als bei normalen Flaschen.“

28 Jahre, 2 Jahre im Beruf, 1 Kind, im Krankenhaus

„Sehr gutes Produkt bei Kindern die sehr schnell trinken und dadurch viel Luft schlucken rund um zufrieden.“

28 Jahre, 5 Jahre im Beruf, 2 Kind, freiberuflich im Krankenhaus



„Zu komplizierter Aufbau.“

31 Jahre, 8 Jahre im Beruf, 1 Kind, freiberuflich

„Es wäre schön, wenn kindgerechte Motive auf den Flaschen wären und die Reinigung einfacher wäre (nicht mikrowellengeeignet und kleines Ventil ist schwer zu reinigen).“

33 Jahre, 7 Jahre im Beruf, 1 Kind, freiberuflich, im Krankenhaus und Arzthelferin

„Die Flasche an sich ist in Ordnung. Das Ventil hat keine spürbare Verbesserung gebracht.“

29 Jahre, 2 Jahre im Beruf, freiberuflich in einer Krankenhaus, Bachelor Hebammenwesen



„Das AirFree System ist anfangs etwas schwer auszubauen und muss für die Reinigung heraus genommen werden. Aus dem Sauger der schon ab dem ersten Monat zugelassen ist, läuft zu viel Flüssigkeit heraus. Das Neugeborene muss sich im Vergleich zum Trinken an der Brust überhaupt nicht anstrengen und wird eher mit zu viel Milch gefüttert. Zur Verwendung parallel zum Stillen kann ich die Flasche nicht empfehlen.“

33 Jahre, 9 Jahre im Beruf, 2 Kinder, freiberuflich, Bachelor Hebammenwesen

„Kriterien für einen guten Sauger leider nicht erfüllt.“

12 Jahre im Beruf, 2 Kind, freiberuflich in einer Gemeinschaftspraxis



„Diese Flasche hat die Mutter in keiner Weise überzeugt.“

54 Jahre, 31 Jahre im Beruf, 3 Kinder, freiberuflich in einer Gemeinschaftspraxis

„Es scheint noch nicht ausgereift zu sein. Mein Kind hat sich mehrmals so sehr verschluckt, dass er alles wieder erbrochen hat.“

27 Jahre, 1 Jahr im Beruf, 1 Kind, freiberuflich im Krankenhaus

Anhang

Bewertungsschlüssel			
Prozent	Bewertung	Noten*	Sterne
100 - 91	sehr gut/ 1	1 - 1,5	5
90 - 75	gut/ 2	1,6 - 2,5	4
74 - 58	befriedigend/ 3	2,6 - 3,5	3
57 - 50	ausreichend/ 4	3,6 - 4,6	2
49 - 30	mangelhaft/ 5	4,6 - 5,5	1
29 - 0	ungenügend/ 6	5,6 - 6	0

*Note: Anzahl der Stimmen * Bewertung / Anzahl der Teilnehmer

Hebammen-
testen.de



Ihre Ansprechpartnerinnen bei Fragen oder
für weitere Informationen

Isabel Dehmer

dehmer@hebammen-testen.de

T +49 (0)6151.15912-50

Tami Best

best@hebammen-testen.de

T +49 (0)6151.15912-50